



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE21.1541

产品名称  
Name of Product 涡轮流量计

型号及规格  
Type of Product LWG


防爆标志  
Marking Ex d II CT6 Gb

技术文件  
Technical Documents Q/MK 002-2021

图号  
Drawing No. LWG-000

备注  
Note (s)

1. 额定电压：DC24V/DC3.6V。
2. 额定电流：4-20mA。
3. 外壳防护等级：IP65。

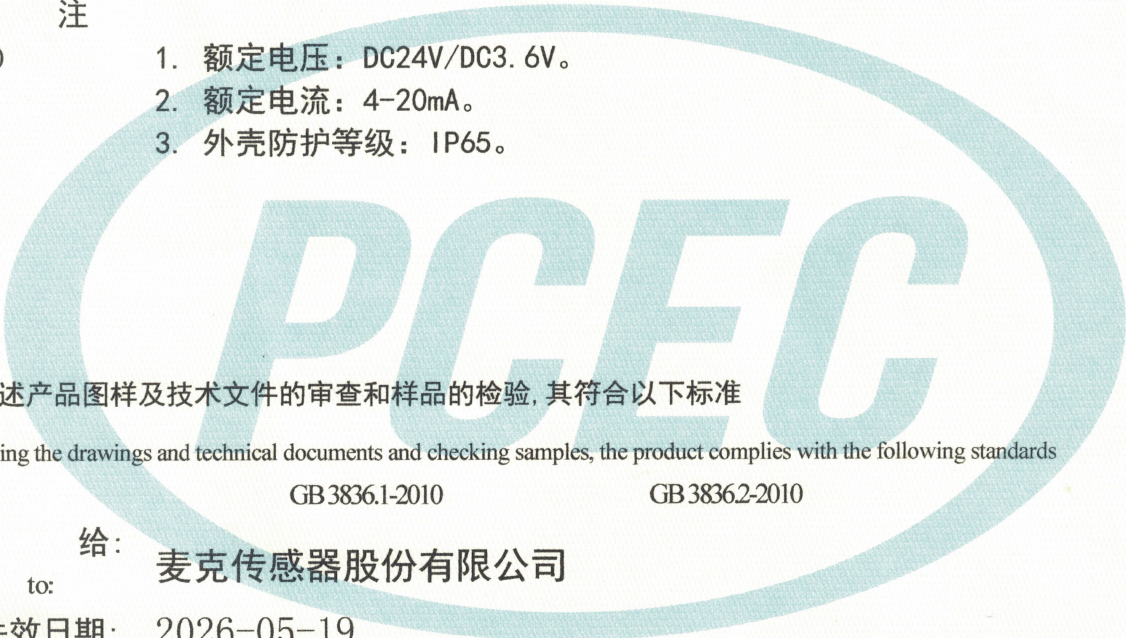

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 麦克传感器股份有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2026-05-19

Date of Expire:

发证日期: 2021-05-19

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)  
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
 National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>